
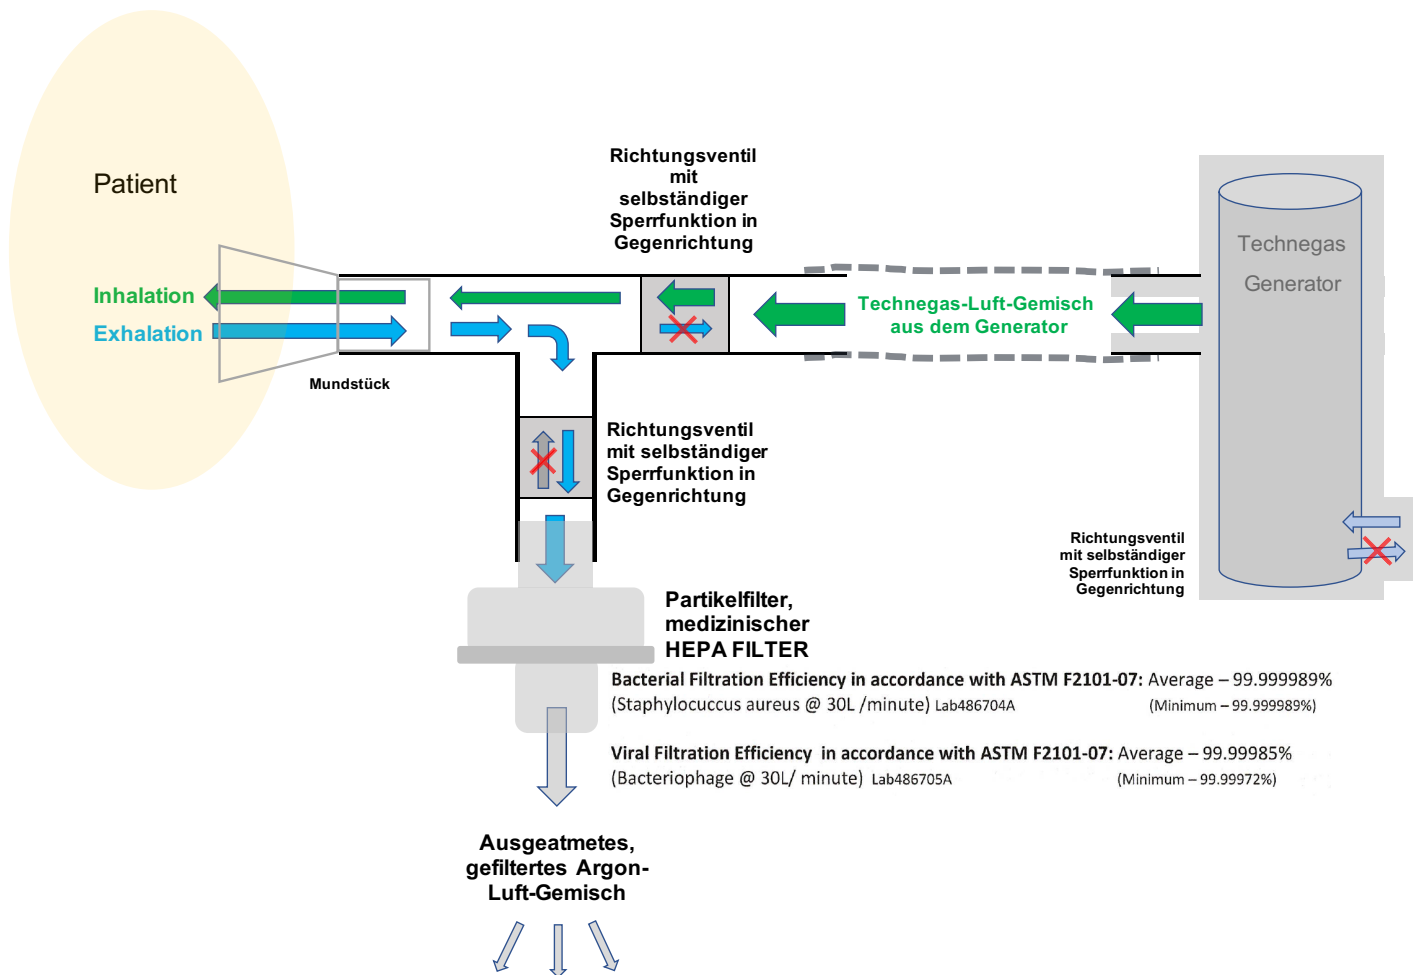


Funktionsweise des almedis-Set zur Verabreichung von Technegas an den Patienten

27.03.2020 AR



Beim Ausatmen ist der Filterauslass immer offen und drucklos, auch bei der optionalen Verwendung des Technegas-Plus mit dem TechnegasPlus-Generator